アルミニウム軽合金製松葉杖杖

ボタン伸縮型アルミ松葉杖　取扱説明書

この度は、当杖をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。
下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申しあげます。

****

☆この取扱説明書は大切に保存してください。☆

****

【特徴】

丈夫なアルミ軽合金製で安心してご使用いただけます。
全長の調整はボタン伸縮型で簡単に調節できます。

【寸法調整の方法】

全長

プッシュボタン(高さ調整ボタン)式による高さ調整が可能です。

1. セーフティナットを緩めます。
2. 伸展棒の高さ調整ボタンを指で強く押し込みながら伸展棒を抜き差しして高さ調整をします。
3. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出したことを確認します。
4. 調整後は、セーフティナットをしっかり締めます。(締め過ぎないようにする事)　　　　（裏面図Ｂ参照）

脇下

ボルトナット式による高さ調整です。

1. 蝶ナットを緩めボルトからワッシャと一緒に外し、ボルトを本体から抜き取ります。
2. 希望の高さに握り位置を決めてボルトを差し込み、ワッシャと共に蝶ナットで固定します。
3. 調整後は、蝶ナットをしっかり締めます。(締め過ぎないようにする事)

【正しい寸法の決め方】

◆ 松葉杖は１図の様なフィッティングポジションにて調整します。
◆ まず、患者が真っ直ぐ立った状態で杖に先ゴムを装着し、脇下に直接枕が触れないよう約５ｃｍ位すく様に全長を調整します。　図1参照
◆ 次ぎに、握りの位置をいつも肘がやや曲る程度に調整します。　調整後の姿勢として、図２の様に爪先外側前方に杖先を置いて、やや前屈みになるような姿勢（突立ってしまわない様に）になる様に調整してください。

【製品の規格】

※全長は最下段寸法表示を参照してください。

【使用上の注意】⚠

◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。
◆ 不適当な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
◆ 松葉杖の部品に破損、ひび割れや割れが出た場合は廃棄して新しいものを使用してください。。
◆ 使用前・使用中も高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出していることを確認して歩行してください。
◆ 使用に当っては伸展棒用高さ調整ボタンがきっち　りと突出して伸展棒がきっちり固定されている事、　セーフティーナット及び各ボルトの蝶ナットが緩　んでいない事を確認してから使用してください。
◆ もし緩んでいる場合はきちんと締めてから使用してください。
◆ 伸展棒用セーフティーナットは、ぶれ止めと防音用の機能しかありませんので、セーフティーナットだけでの高さ調整維持大変危険ですので止めてください。
◆ 脇パッドや握りパッドは消耗品です。劣化した場合は交換してください。（経時変化でも劣化します。）
◆ 杖の先ゴムはきちんと装着して使用してください。
◆ 先ゴムは消耗品です。摩耗している場合は、新しい正しいサイズの先ゴムを装着してください。
◆ 寸法を調整する場合、部品をなくさないよう注意してください。組み立てる場合は各部品を省略しないで組み立ててください。
◆ 濡れたりして滑べりやすい床面、路面を歩行する場合は充分気を付けて歩行してください。
◆ 濡れ面を歩行すると、ゴムの跡形が床面に付着する場合が有りますので注意してください。
◆ 先ゴムには油を付けないようにしてください。
◆ 寸法が正しく調整されないと正しい歩行が出来ないばかりか体によくないことが起る可能性が出てきますので寸法・歩行方法等は医師や専門アドバイザーの方に、正しい歩行方法　を指導して頂いてください。
◆ 貸し出しされる場合は特に安全を確認しフィッティングに留意してくさい。
◆ 松葉杖の標準的な耐用年数は使用開始から約４年です。
◆ 用途以外（登山・護身用等）に使用しないでください。
◆ 1 人専用が望ましい使用方法ですが、貸与等される場合は使用者自身の始業点検と、貸与業者の定期点検を怠らないように使用してください。
◆ 使用後の手入れは、乾燥させてきれいに清掃してしまってください。但し、長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。

大	
全　長	124～144cm　約 2.5cm 間隔
脇　下	36.5～51.5cm
重　量	約 1920g
中	
全　長	144～134cm　約 2.5cm 間隔
脇　下	36.5～51.5cm
重　量	約 19200g
小	
全　長	96～116cm　約 2.5cm 間隔
脇　下	23.5～38.5cm
重　量	約 1680g
材　質	本体：アルミ軽合金
原産国	台湾

交換用先ゴムの内径　特大・大中小：29mm φ
　　　　　　　　　　極小：20mm φ
標準の耐用年数　４年
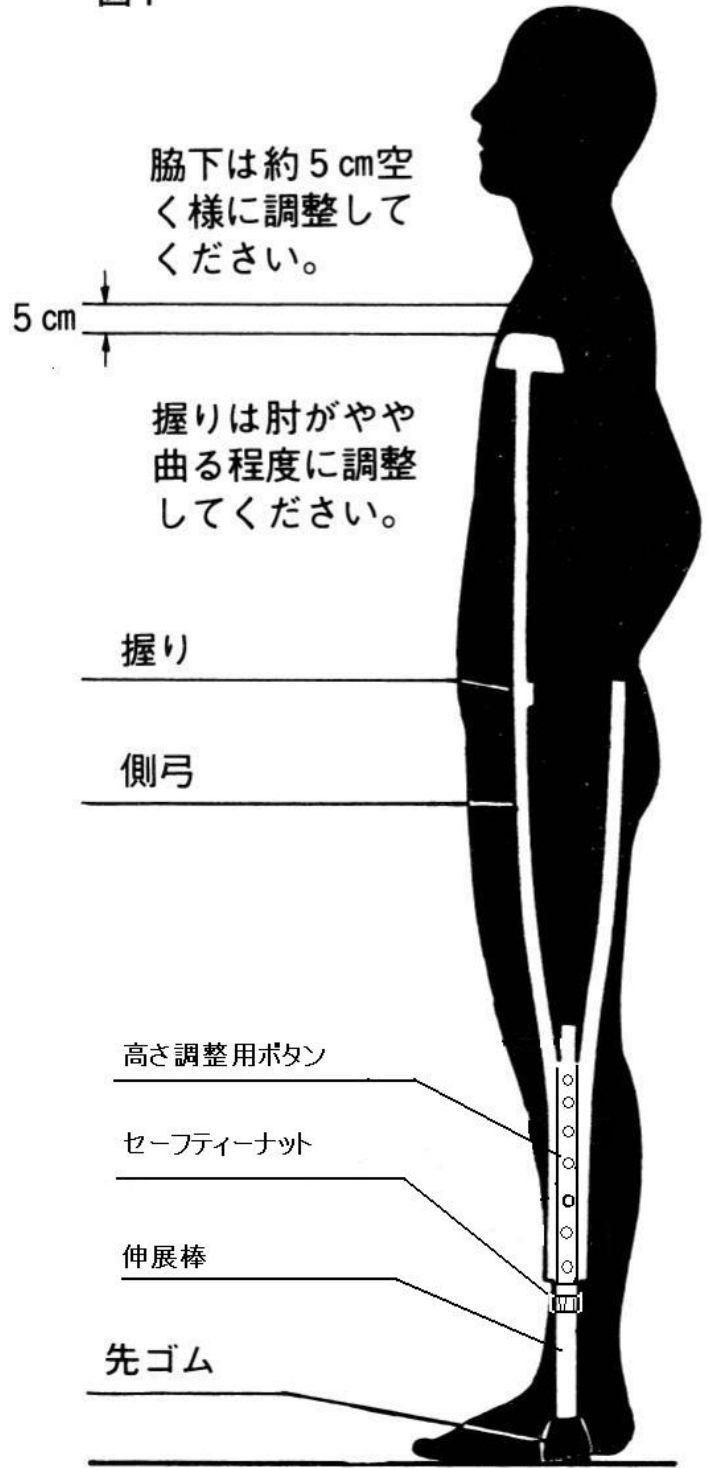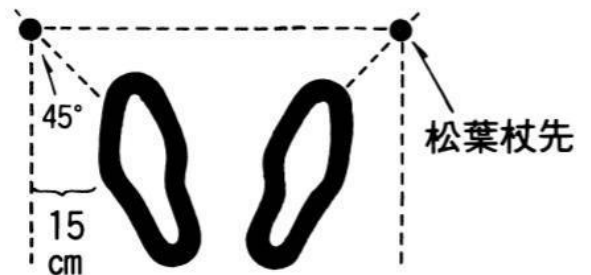
株式会社　赤　　井

〒558-0011　大阪市住吉区苅田8丁目11番19号
お問い合わせ、御相談はお客様相談室　06-6608-0562